

Подъёмник для бассейна Карта заказа

Для оформления заказа подъёмника заполните таблицу 1 в конце документа с указанием уточняемых размеров, типа подъёмника (характеристики подъёмников уточняются отдельно у менеджера) и дополнительной информации.


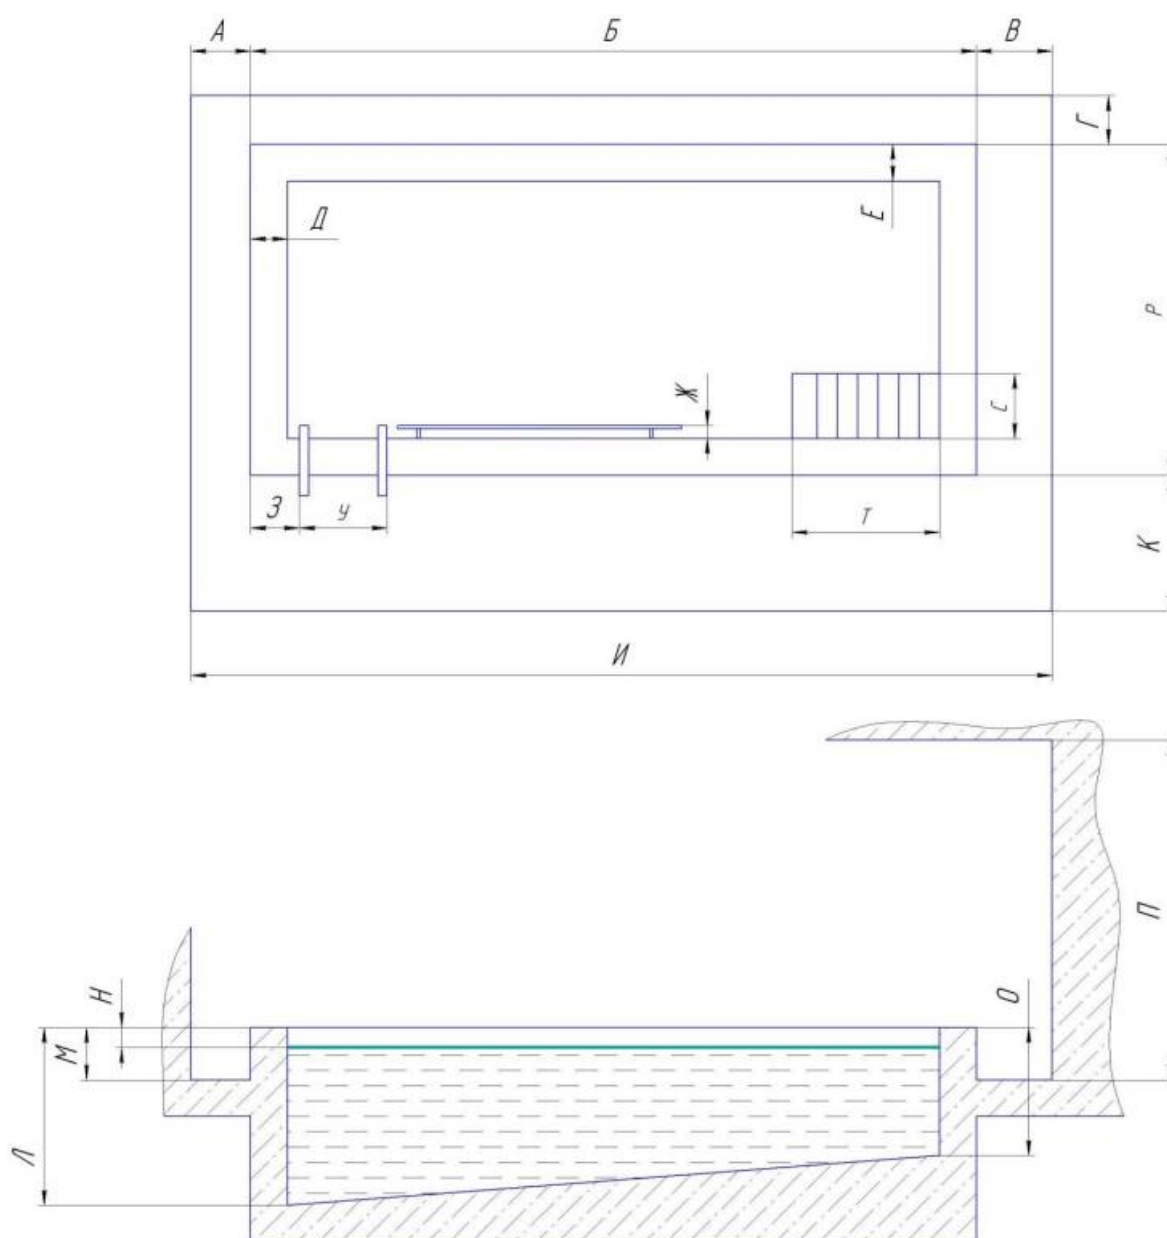



Схема строительная помещения с бассейном

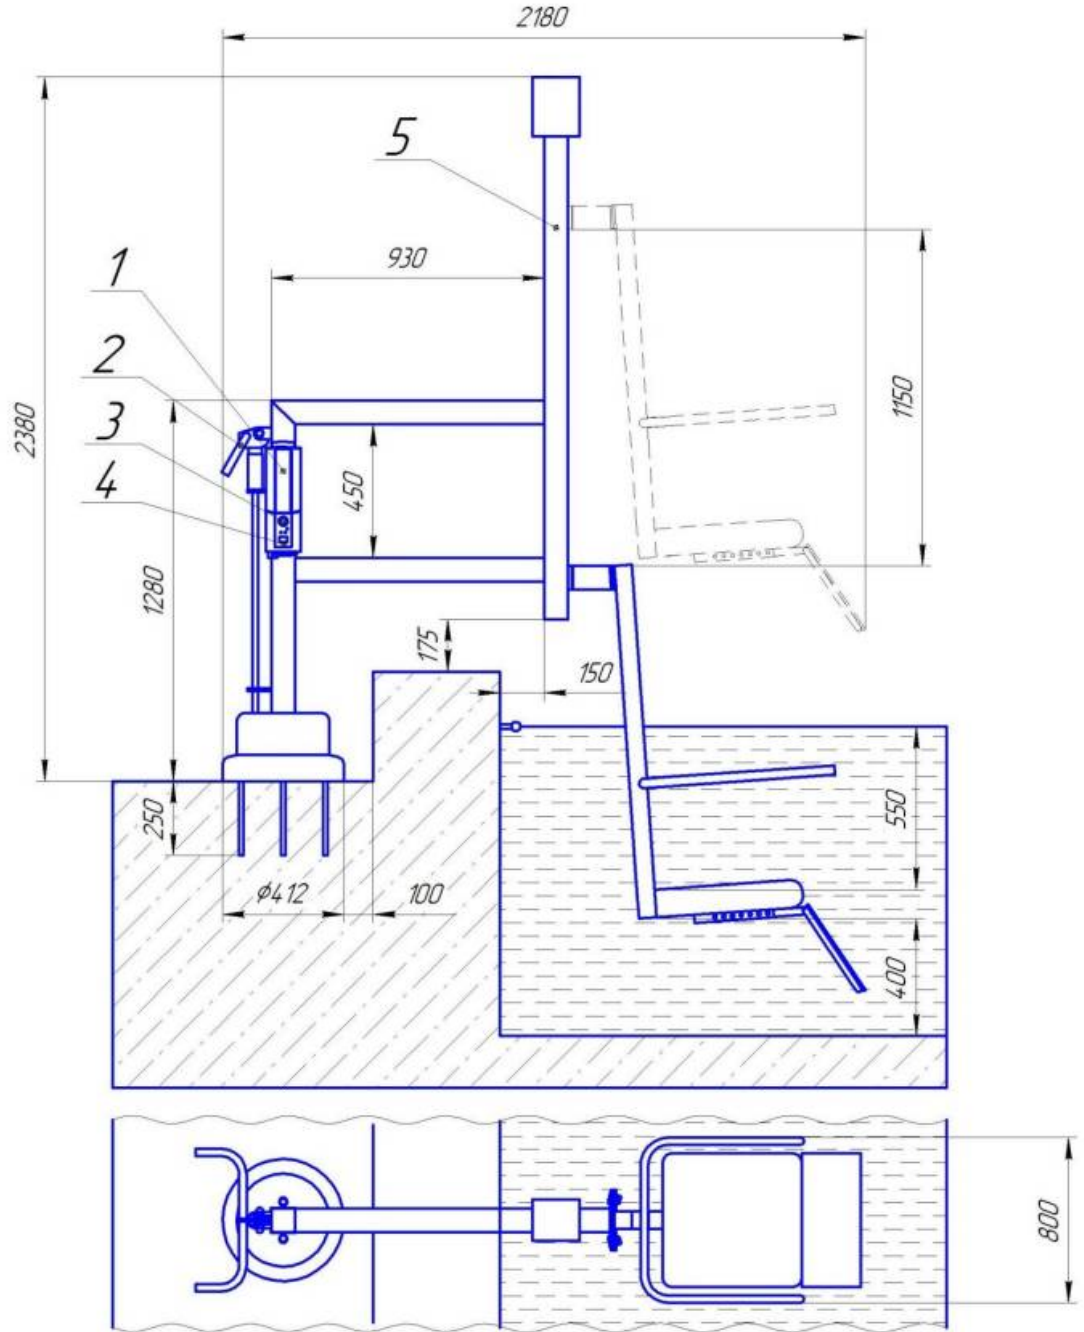

- 1 – Аккумуляторная батарея
- 2 – Ручка поворота и стопорного механизма
- 3 – Кнопка включения блока управления
- 4 – Блок управления
- 5 – Колонна подъемника с ходовым винтом

Подъёмник для бассейна винтовой (исполнение 1)


Размеры справочные, после согласования корректируются

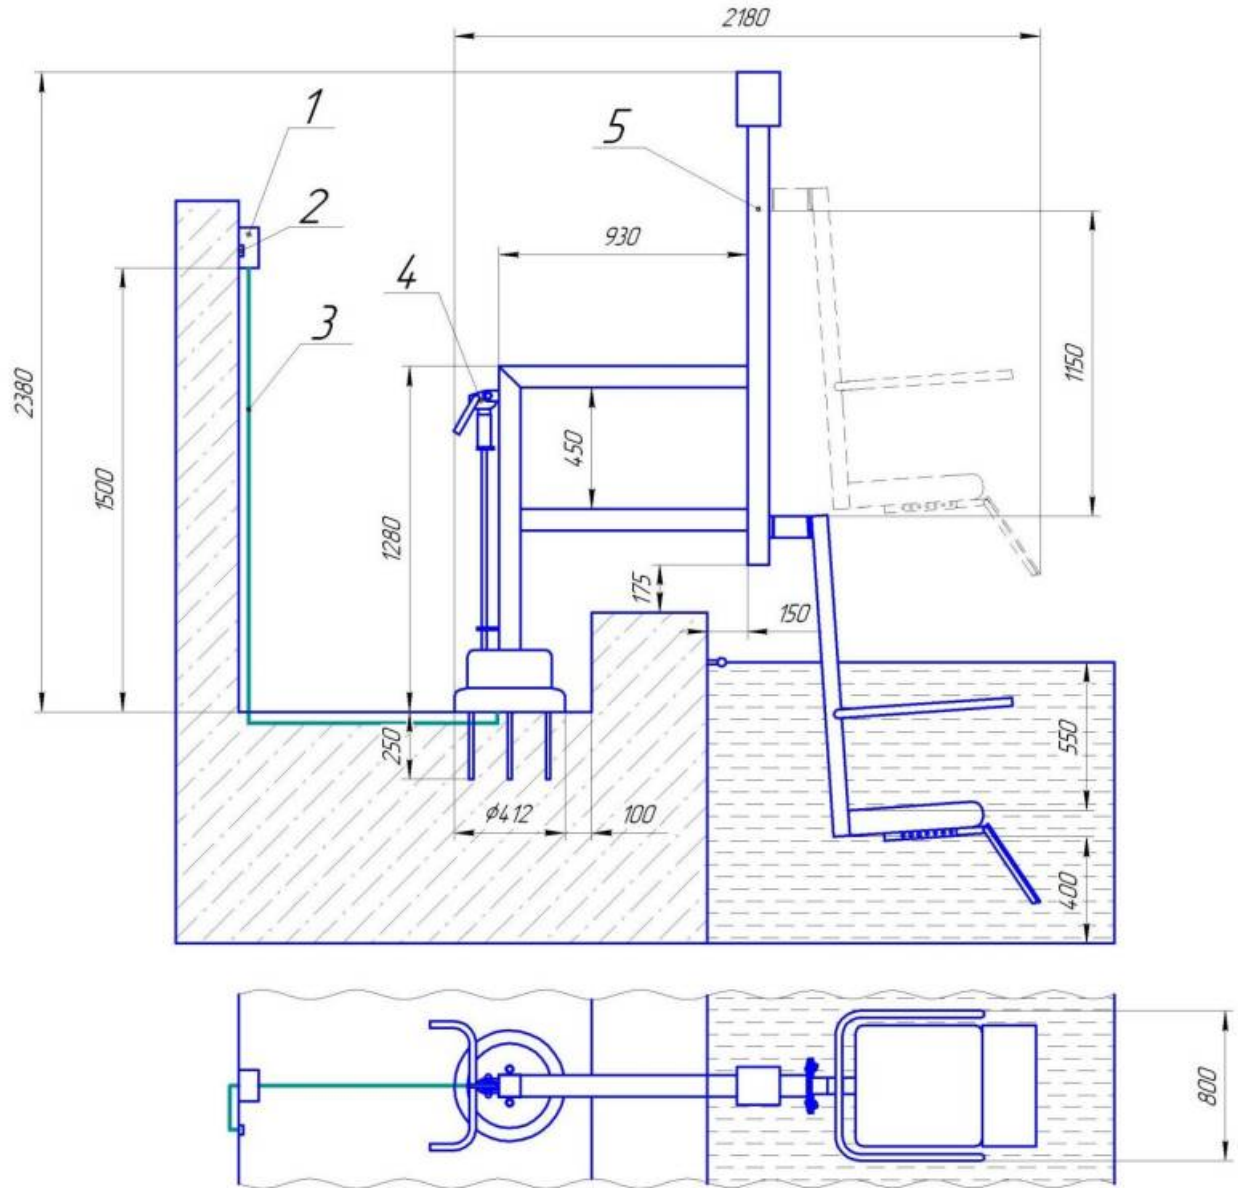


- 1 – Блок питания 220/24В
- 2 – Влагостойкая розетка с заземлением
- 3 – Питающий кабель ВВГ 2х15
- 4 – Ручка поворота и стопорного механизма
- 5 – Колонна подъемника с ходовым винтом

Подъёмник для бассейна винтовой (исполнение 2)

Размеры справочные, после согласования корректируются

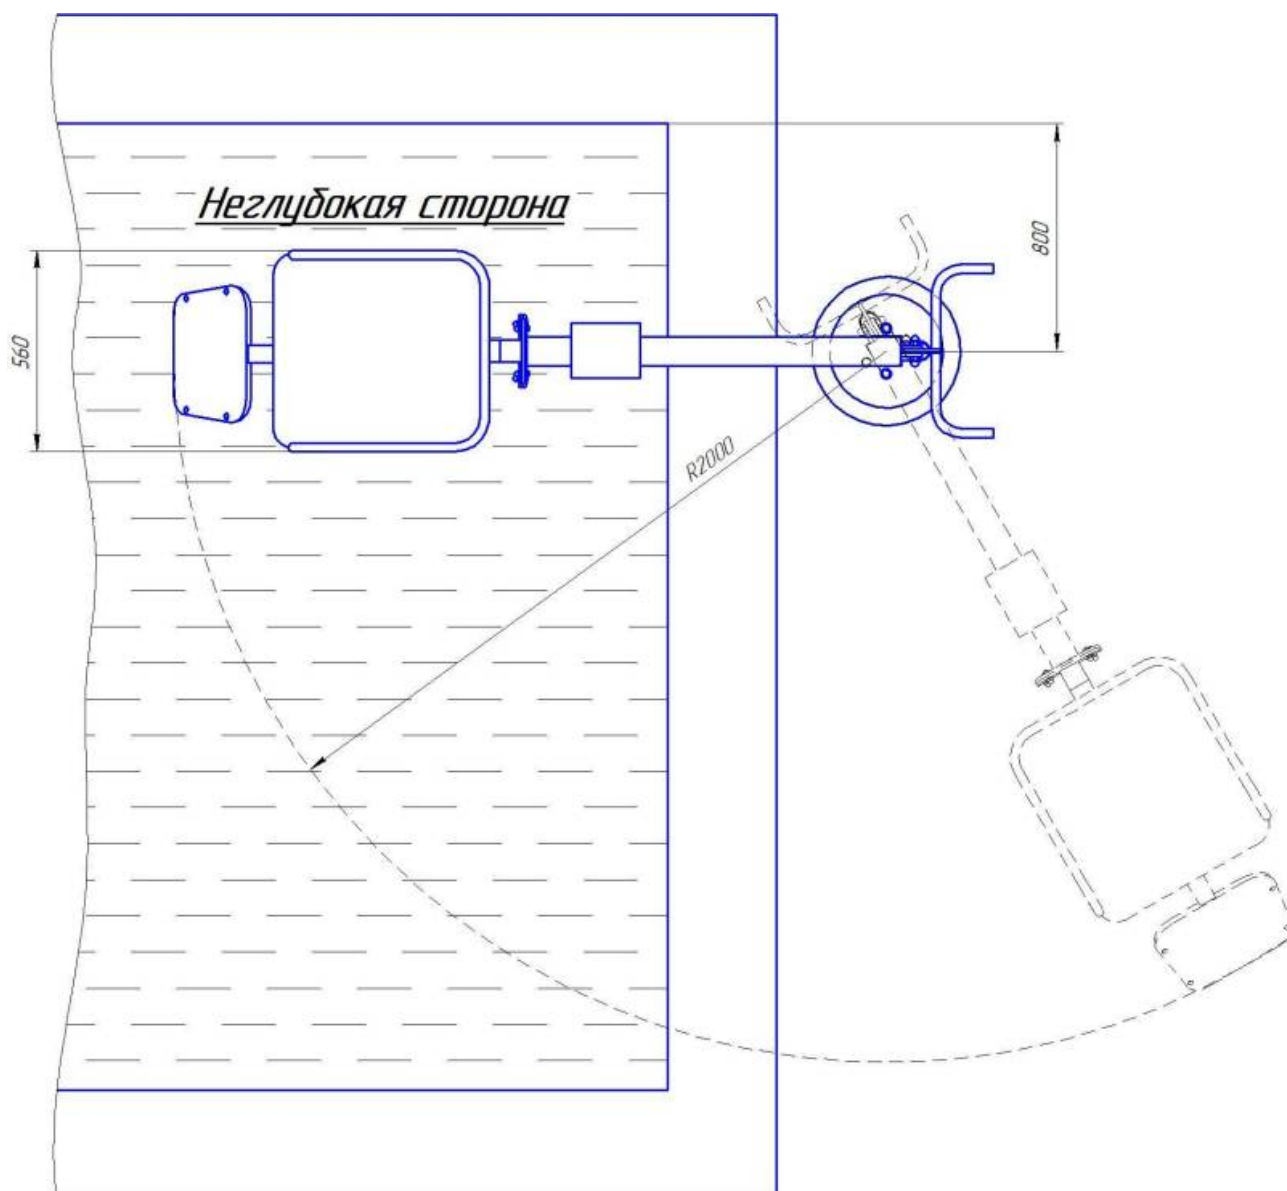


Размеры справочные, после согласования корректируются

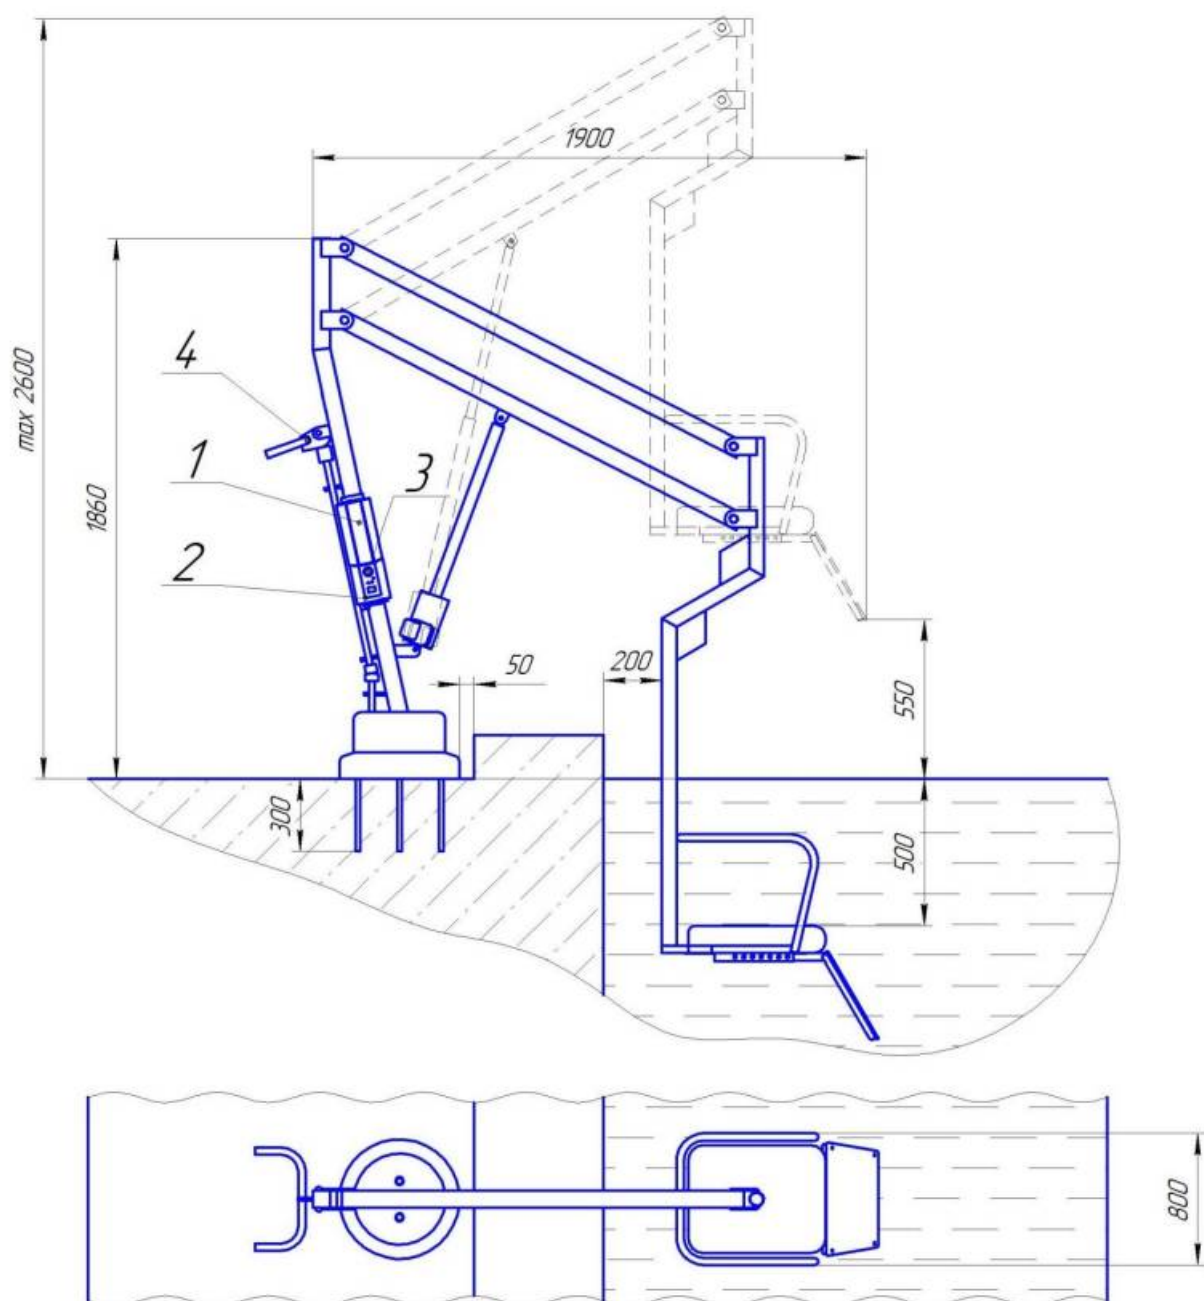

- 1 – Аккумуляторная батарея
- 2 – Блок управления
- 3 – Кнопка включения блока управления
- 4 – Ручка поворота и стопорного механизма

Подъёмник для бассейна (исполнение 1)


Размеры справочные, после согласования корректируются

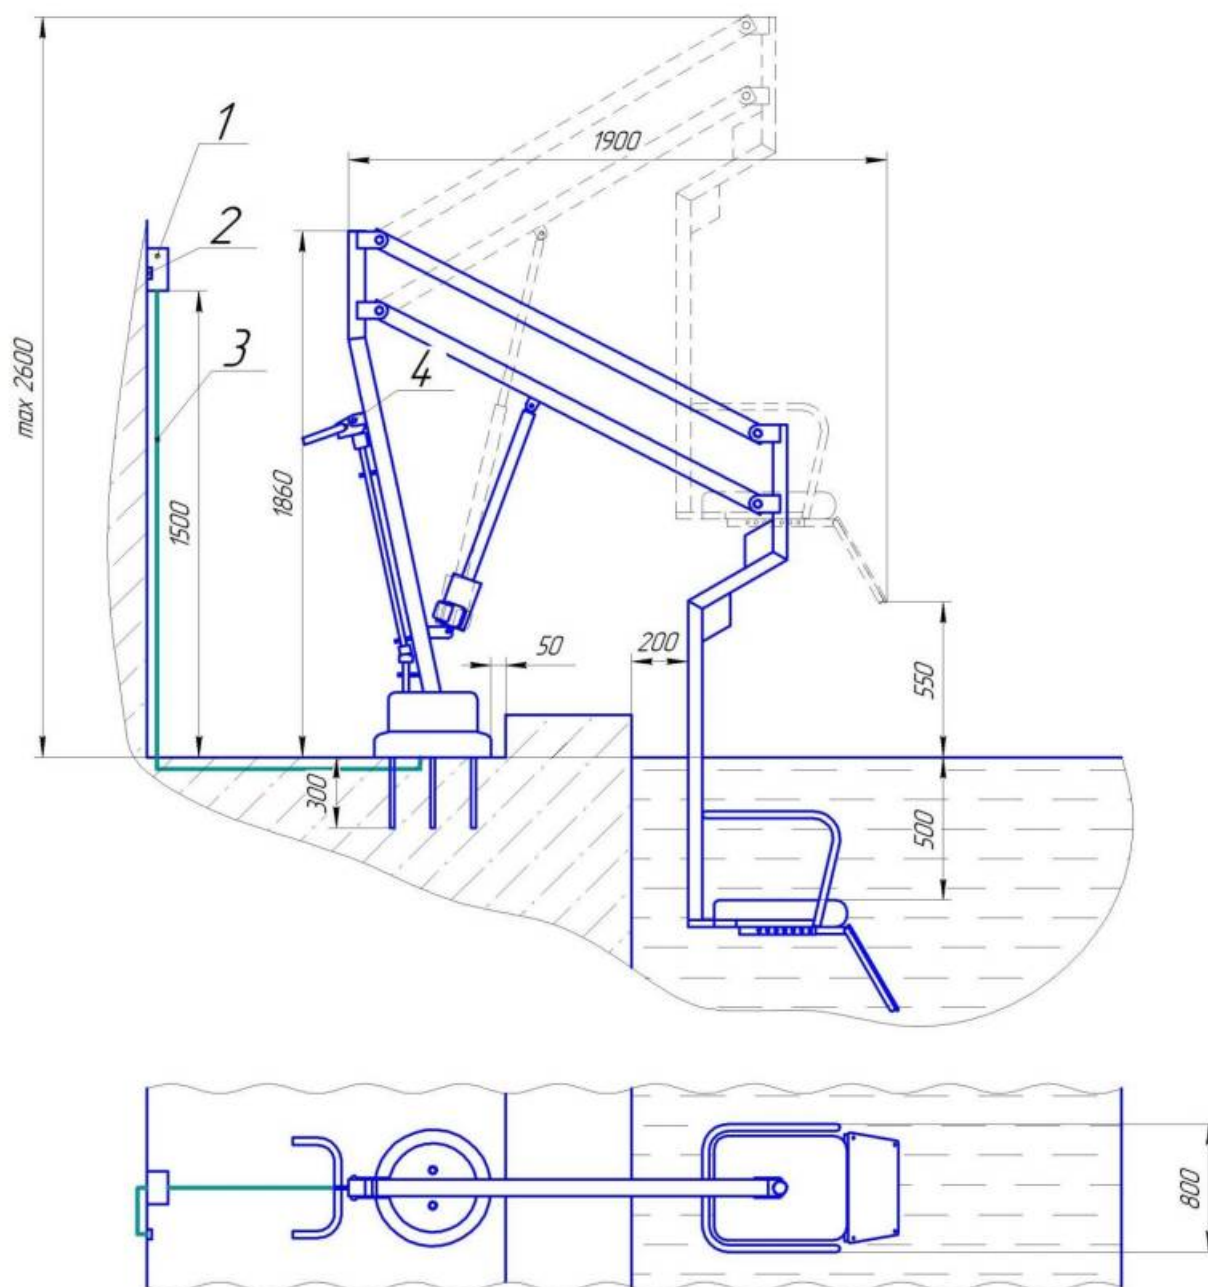

- 1 – Блок питания 220/24В
- 2 – Влагостойкая розетка с заземлением
- 3 – Питающий кабель ВВГ 2х15
- 4 – Ручка поворота и стопорного механизма

Подъёмник для бассейна (исполнение 2)


Размеры справочные, после согласования корректируются

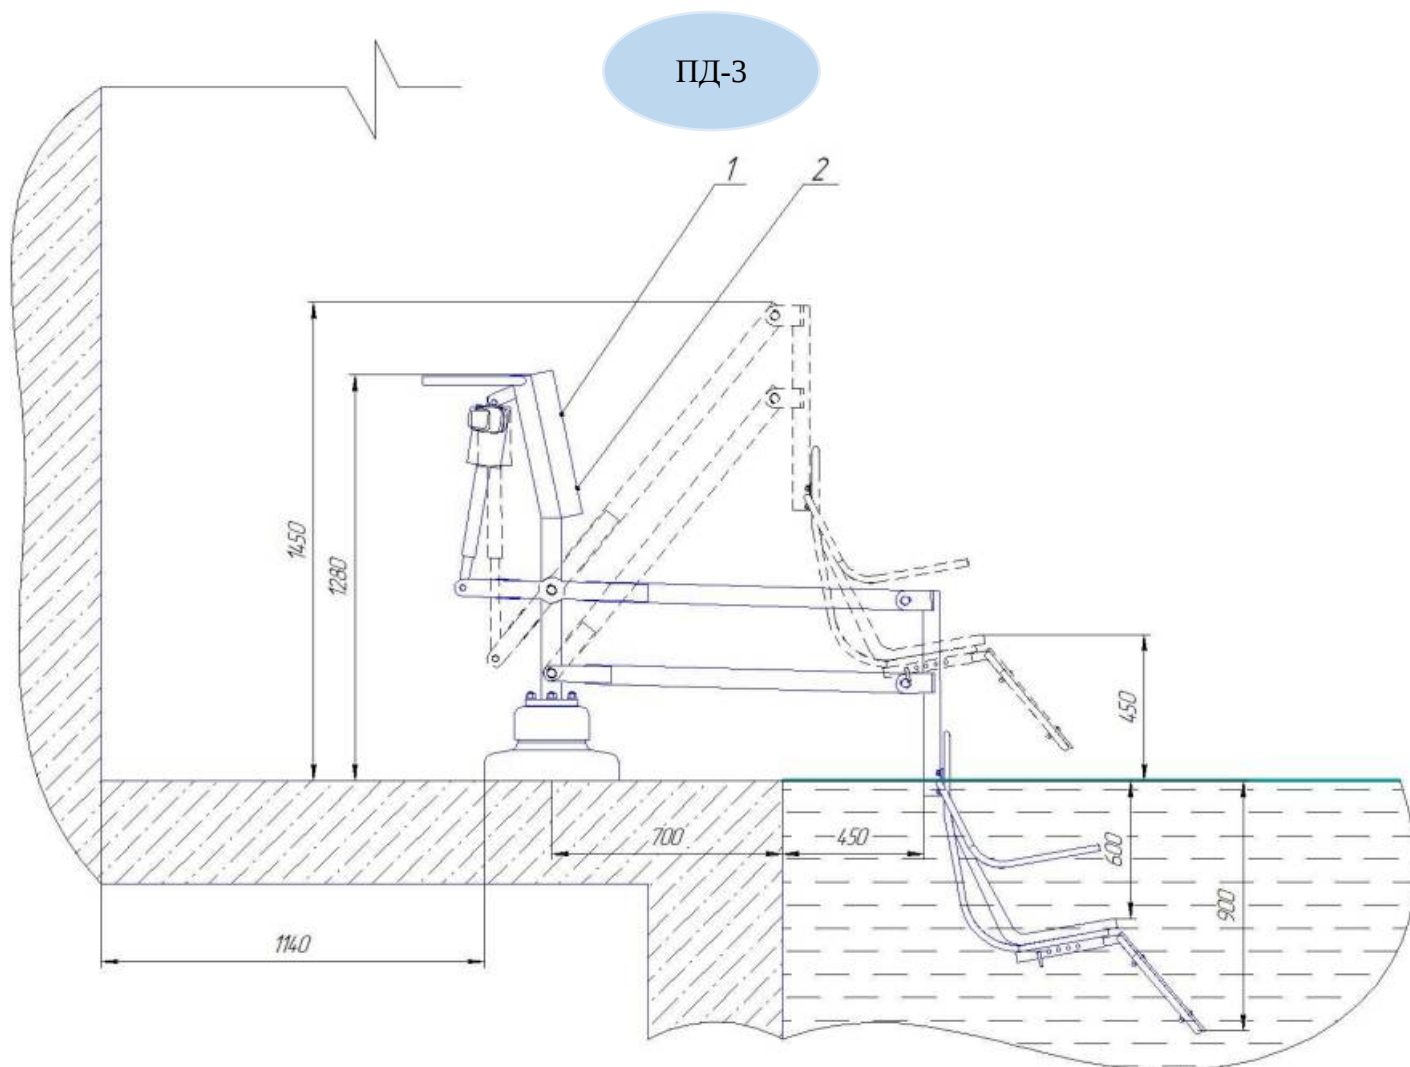

Подъёмник для бассейна (исполнение 3)

На рисунке: 1 – аккумулятор, 2 – блок управления.

Размеры справочные, после согласования корректируются

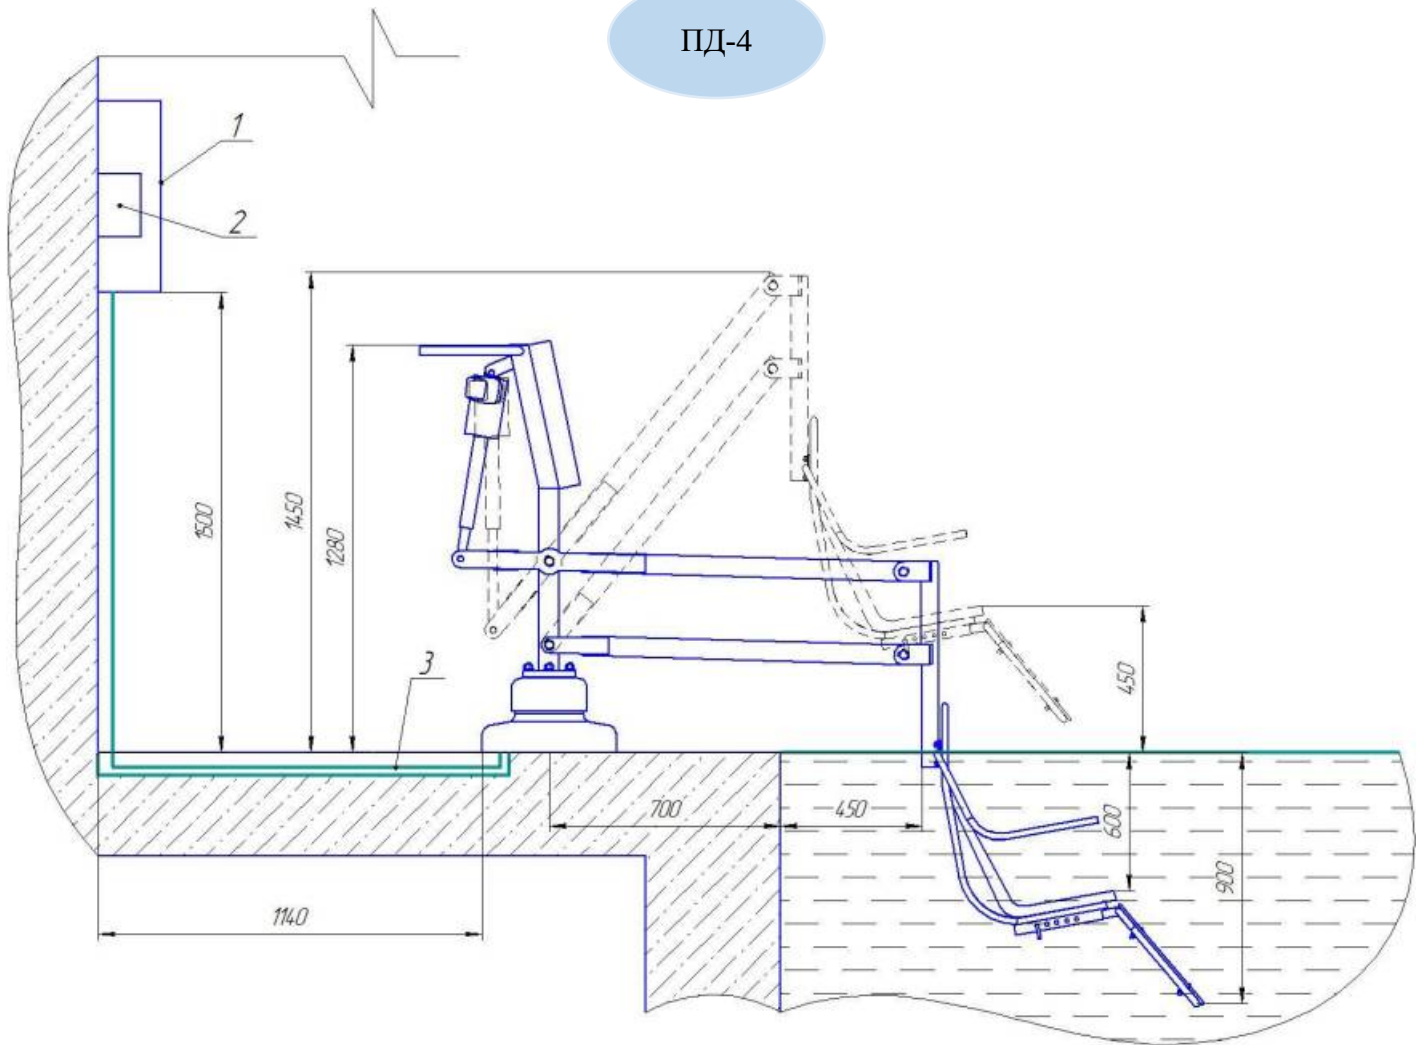

Подъёмник для бассейна (исполнение 4)

На рисунке: 1 – блок питания 24 В; 2 – розетка с заземлением 220 В, IP55 устанавливается в радиусе 0,5 метра от блока питания 24 В; 3 – Кабель ВВГ 2х1,5 (проложить в кабельной трассе, от блока питания прокладывать в трубе гофрированной ПНД $\varnothing$ 20 мм, со стороны блока питания свободный конец 0,5 метра, со стороны установки 0,5 метра).

Размеры справочные, после согласования корректируются

Таблица 1

№	Характеристика	Значение
1.	А	
2.	Б	
3.	В	
4.	Г	
5.	Д	
6.	Е	
7.	Ж	
8.	З	
9.	И	
10.	К	
11.	Л	
12.	М	
13.	Н	
14.	О	
15.	П	
16.	Р	
17.	С	
18.	Т	
19.	У	
20.	Тип подъёмника (из схем)	
21.	Упор для ног (указать необходимость)	
22.	Ремни на сиденье (указать необходимость)	
23.	Откидные подлокотники (указать необходимость)	
24.	Наличие бортиков бассейна	
25.	Наличие переливных лотков	
26.	Расположение глубокой и неглубокой части по схеме бассейна	
27.	Наличие поручней в бассейне, шт.	
28.	Наличие тёплого пола	
29.	Внутренний материал полов	
30.	Внутренний материал бортиков	
31.	Покрытие полов и бортиков	
32.	Желаемое размещение подъёмника (место на схеме, на полу или на бортике)*	
33.	Наличие подвального помещения в месте установки подъёмника	
34.	Толщина пола (при наличии подвального помещения)	

*Из соображений безопасности и удобства погружения пациентов рекомендуется проектировать расположение подъёмника у неглубокой стороны бассейна.